

Klient _____

Płeć: kobieta

Data zamówienia/
 pomiaru _____

mężczyzna

Osoba do kontaktu/
 zwrotny nr telefonu _____

inna

 Firma/pieczątką


JOBST		Elvarex			Elvarex Plus [▲]		Elvarex Soft Seamless	
1	Klasa ucisku (CCL)	1	2	3	1	2	1	2
L. sztułki	lewa stopa							
	prawa stopa							

2	Opcje	Elvarex	Elvarex Plus [▲]	Elvarex Soft Seamless
4 palce		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/> standard
	5 palców	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

3	Wykończenia	Elvarex	Elvarex Plus [▲]	Elvarex Soft Seamless
skos otworu małego palca		<input type="radio"/> 0,5 cm	<input type="radio"/> 0,5 cm	
		<input type="radio"/> 1,0 cm	<input type="radio"/> 1,0 cm	
		<input type="radio"/> 1,5 cm	<input type="radio"/> 1,5 cm	<input checked="" type="checkbox"/> 1,5 cm standard

4	Kolor	Elvarex *	Elvarex Plus *	Elvarex Soft Seamless *
JOBST Elvarex *		<input type="radio"/> beige	<input type="radio"/> grey	
		<input type="radio"/> black	<input type="radio"/> cranberry	
		<input type="radio"/> navy	<input type="radio"/> cocoa	
JOBST Elvarex Plus *		<input type="radio"/> beige	<input type="radio"/> grey	
		<input type="radio"/> black	<input type="radio"/> cranberry	
		<input type="radio"/> navy	<input type="radio"/> cocoa	
JOBST Elvarex Soft Seamless *		<input type="radio"/> beige	<input type="radio"/> grey	
		<input type="radio"/> black	<input type="radio"/> cranberry	
		<input type="radio"/> navy	<input type="radio"/> cocoa	
		<input type="radio"/> cherry	<input type="radio"/> pine green	
		<input type="radio"/> sunflower yellow		

▲ JOBST Elvarex Plus
 wymagane jest podanie
 obwodów wszystkich
 5 palców

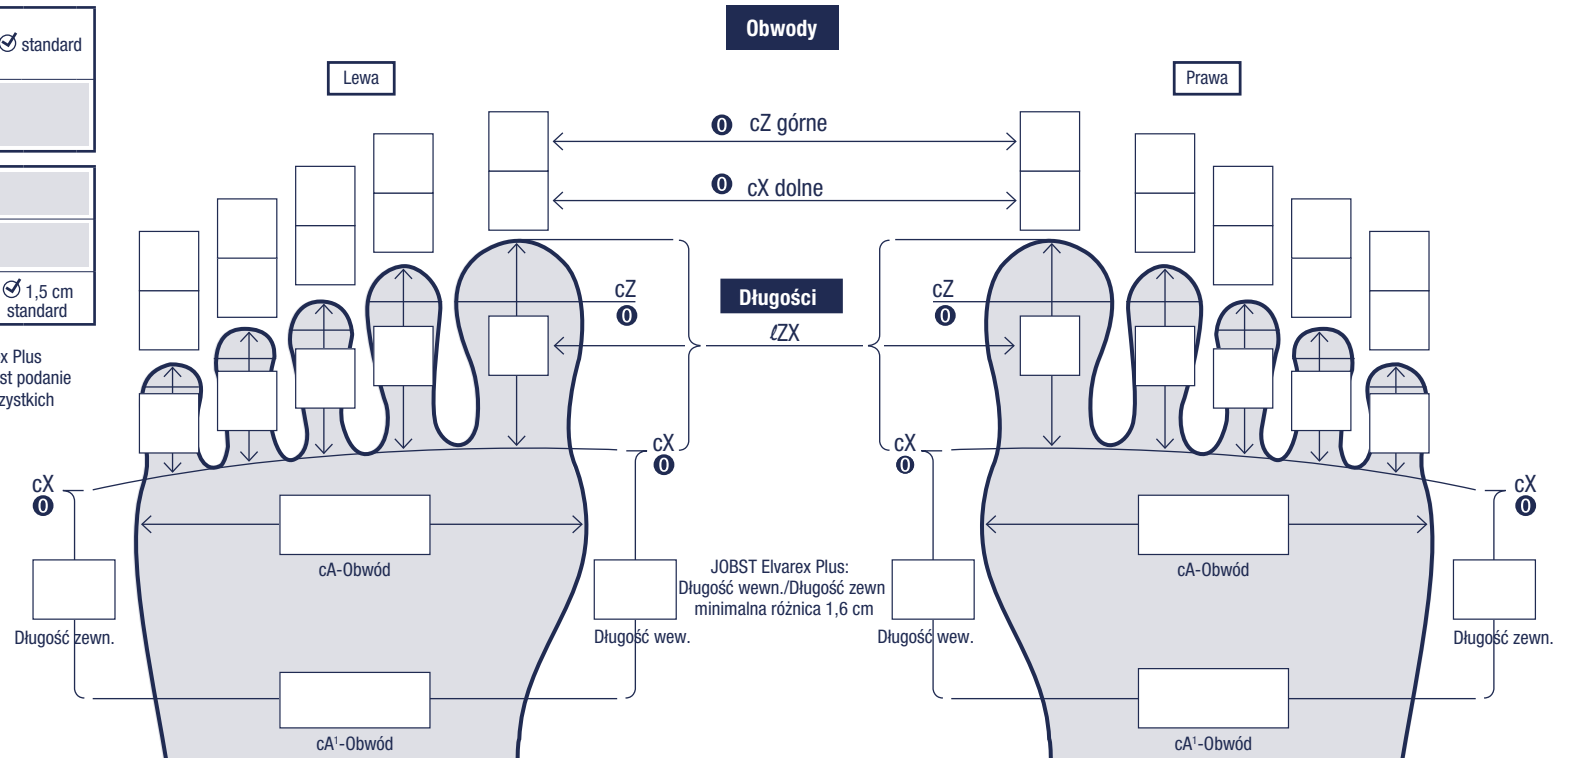

Stosuj różne napięcia miarki: dla zaprojektowania odzieży płaskodzianej z optymalnym efektem terapeutycznym pomiarów obwodów należy dokonywać z różnym napięciem miarki.

⓪ pomiar bez zaciskania miarki

W przypadku stóp, wszystkie pomiary obwodów proszę dokonywać bez zaciskania miarki.

Uwagi